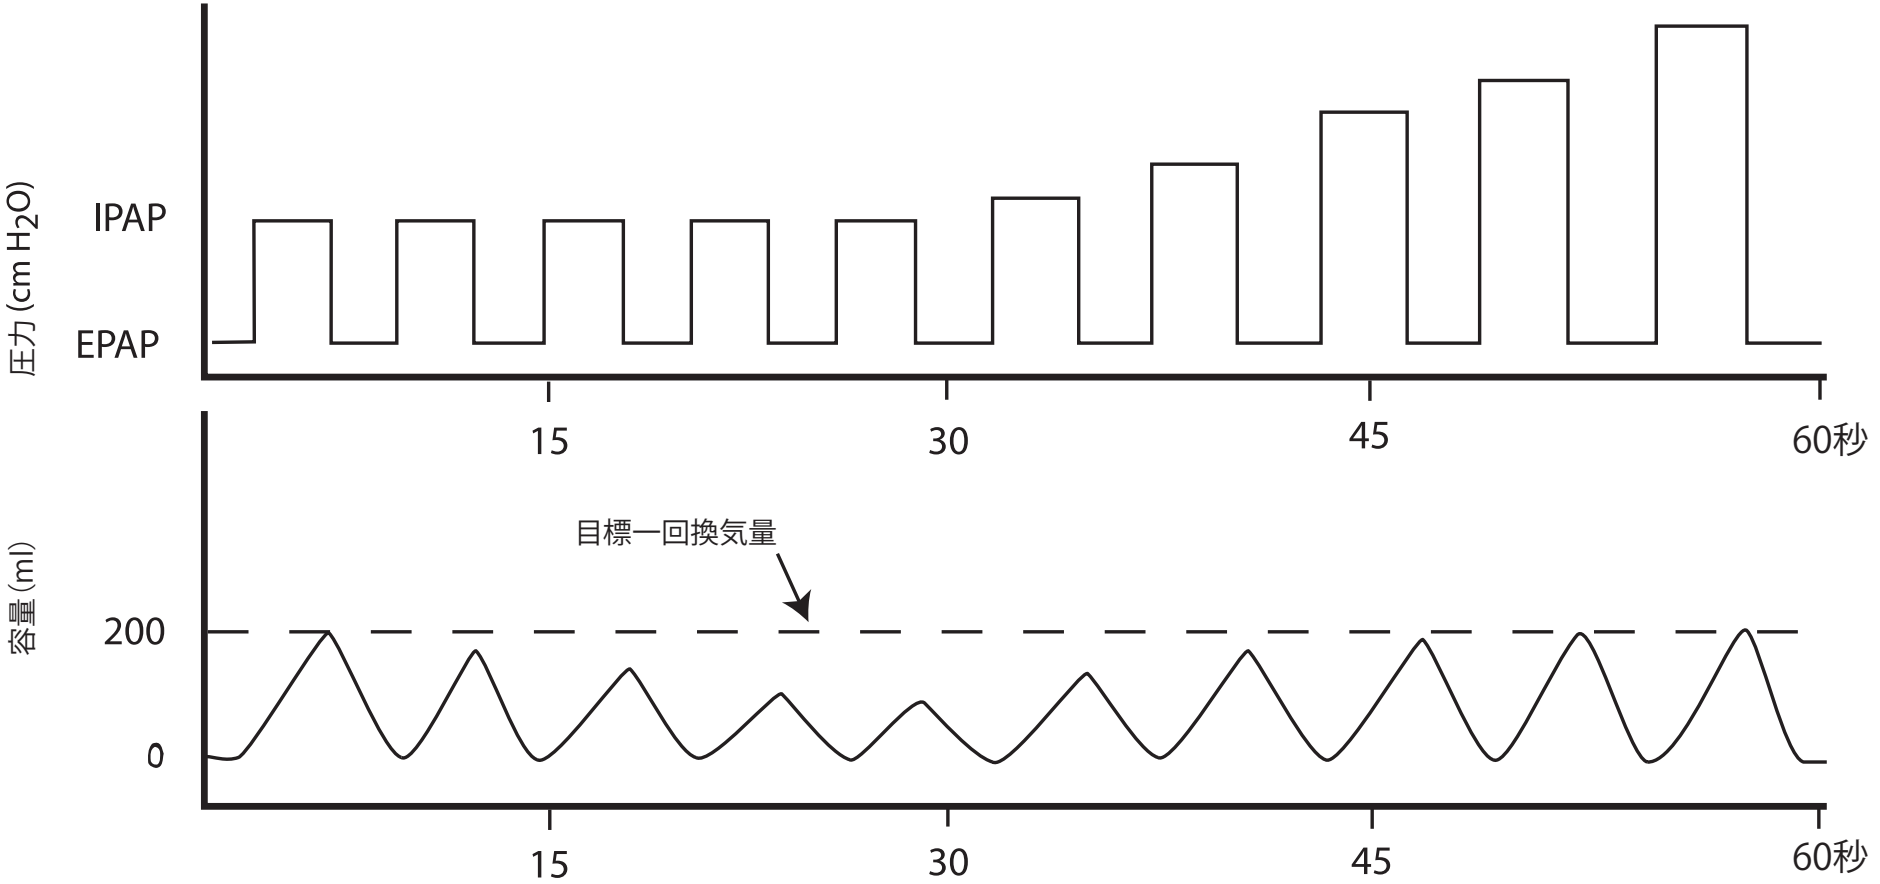
圧力 (cm H_2O)
IPAP
EPAP
15
30
45
60秒
容量 (ml)
目標一回換気量
200
0
15
30
45
60秒