


警告消音

警告確認

No.1
No.2

モード切換
HFO

AMP cmH2O
13.6
MAP cmH2O
12.0
1/1

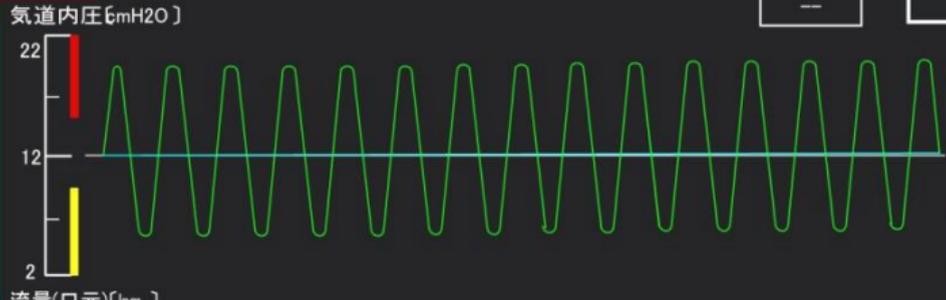

換気設定

警報設定


オプション設定

メニュー


バギング ON

ネブライザ OFF

HFO ベースフロー lpm
10
1/1

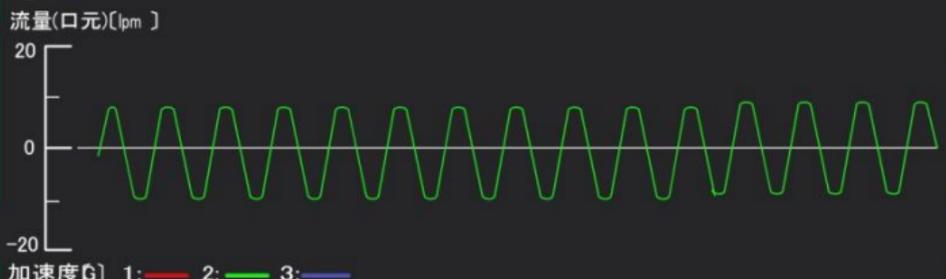

1回換気量 l
2.1
1/1

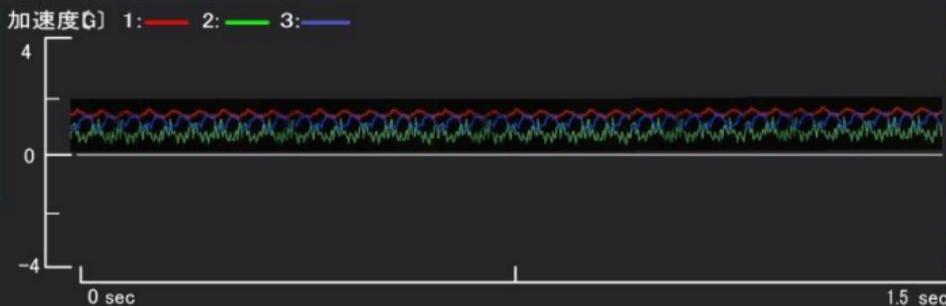

患者データ

ACBATT

酸素濃度
21 %

振動数
15 Hz

MAP
12 cmH2O

SV
8.0