

警報消音


警報確認

No.1
No.2

モード切換
SIMV-従圧換気

呼気


最大吸気圧 cmH2O
15.2
平均気道内圧 cmH2O
8.2
PEEP/CPAP cmH2O
3.0
1/1

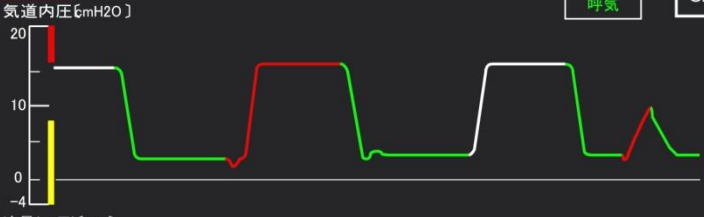

換気設定

警報設定


呼吸回数 bpm
30
1/2

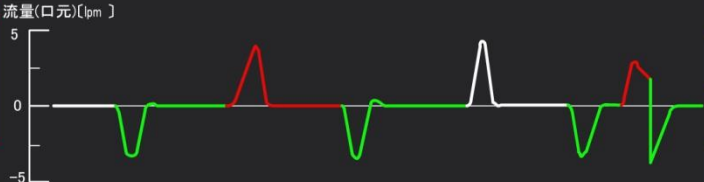

オプション設定

メニュー

1回換気量口元 ml
6.2
1/3

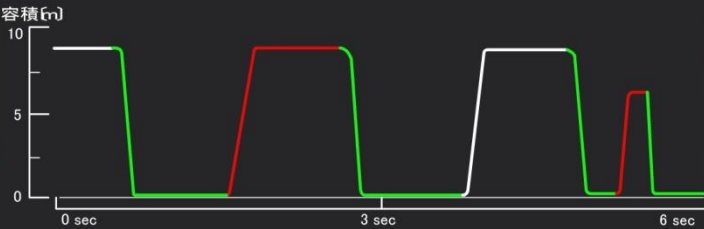

バギング OFF

ネブライザ OFF

患者データ



酸素濃度
21 %

呼吸回数
15 bpm

PEEP/CPAP
3.0 cm H2O

吸気圧
15 cm H2O

